


可调系数数显表

检验证书


数据传输




2501-10

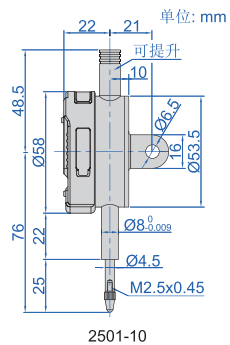


2501-25

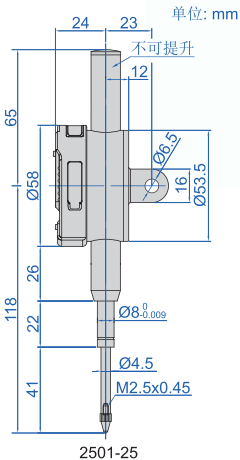

2501-25P

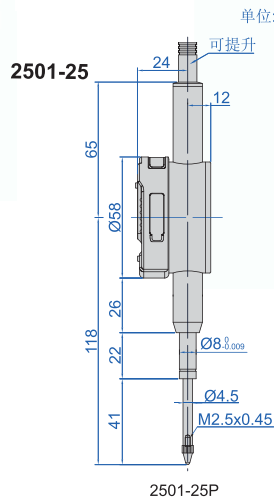

2501-50

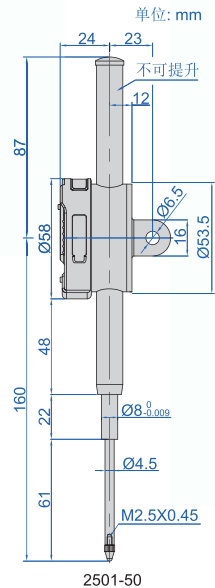

- 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- 显示值=系数x测杆移动量, 系数可调范围为0-9.9999
例如, 可设定系数为4.5562, 测杆移动3.60mm, 则数显表显示为4.5562x3.60=16.40mm
- 按键功能: 开/关, 置零, 设置初始值, 系数设置, 公/英制转换, 切换方向
- 重启后仍保留预先设置的初始值
- CR2032电池, 自动关机(关机时间可调)
- 数据传输
- 可选附件: 数据传输线(型号7315-50M, 7302-40M, 7305-40M), 后盖, 测头

分辨率: 0.01mm/0.0005"

型号	测量范围	全程精度	回程精度	最大测量力	备注
2501-10*	12.7mm/0.5"	20µm	10µm	1.5N	带耳后盖
2501-25*	25.4mm/1"	20µm	10µm	2.2N	带耳后盖
2501-50*	50.8mm/2"	30µm	10µm	2.5N	带耳后盖
2501-10F*	12.7mm/0.5"	20µm	10µm	1.5N	平后盖
2501-25F*	25.4mm/1"	20µm	10µm	2.2N	平后盖
2501-50F*	50.8mm/2"	30µm	10µm	2.5N	平后盖
2501-25P*	25.4mm/1"	20µm	10µm	2.2N	平后盖, 带手提螺帽
2501-50P*	50.8mm/2"	30µm	10µm	2.5N	平后盖, 带手提螺帽

*带生产厂检验证书

2501-25P/50P

